

分娩室1

分娩室2

前室

分娩室3

汚物処理室

廊下


改修前

日付	備考	日付	備考

尺度	A3:S=1/50		
承認	製図	確認	確認

Title	山梨県立中央病院分娩室3改修工事
図面番号	2
Rev.	

作成年月日	PJ No.
2023/06/01	
図面番号	Rev.
2	

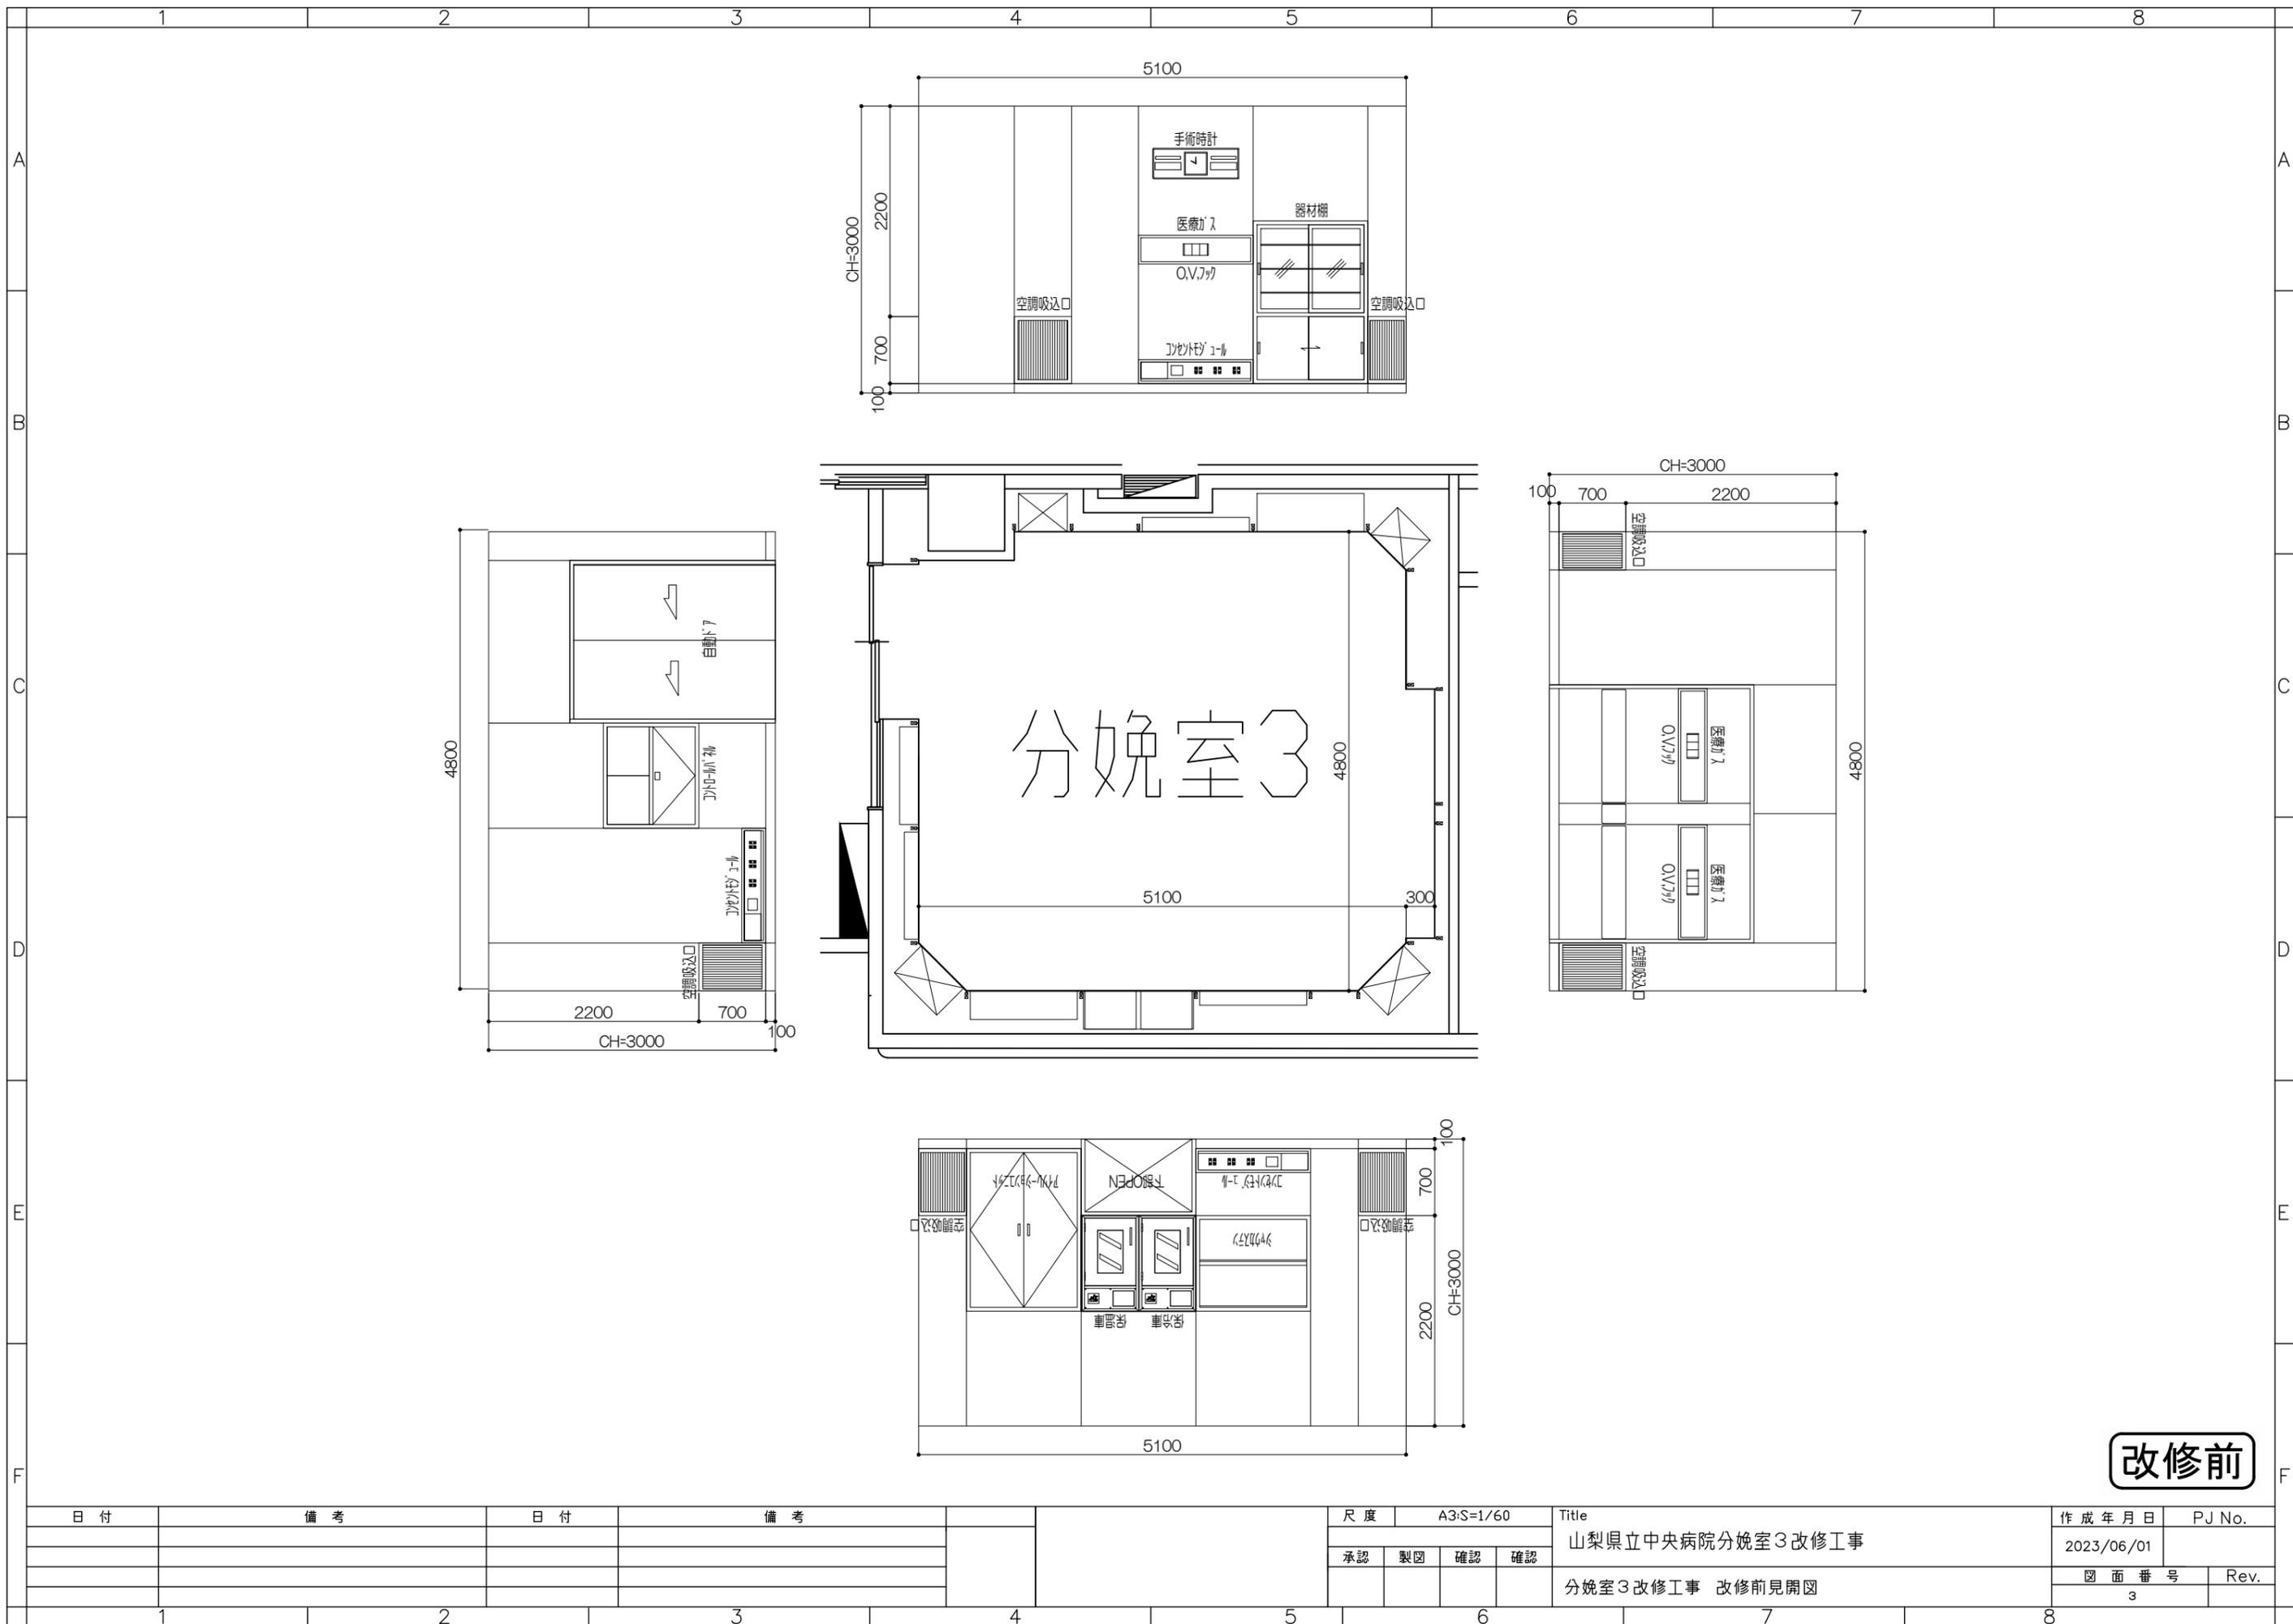


改修前

日付	備考	日付	備考

尺度	A3:S=1/60		
承認	製図	確認	確認

Title	山梨県立中央病院分娩室3改修工事
作成年月日	2023/06/01
図面番号	3
Rev.	

PJ No.	
Rev.	

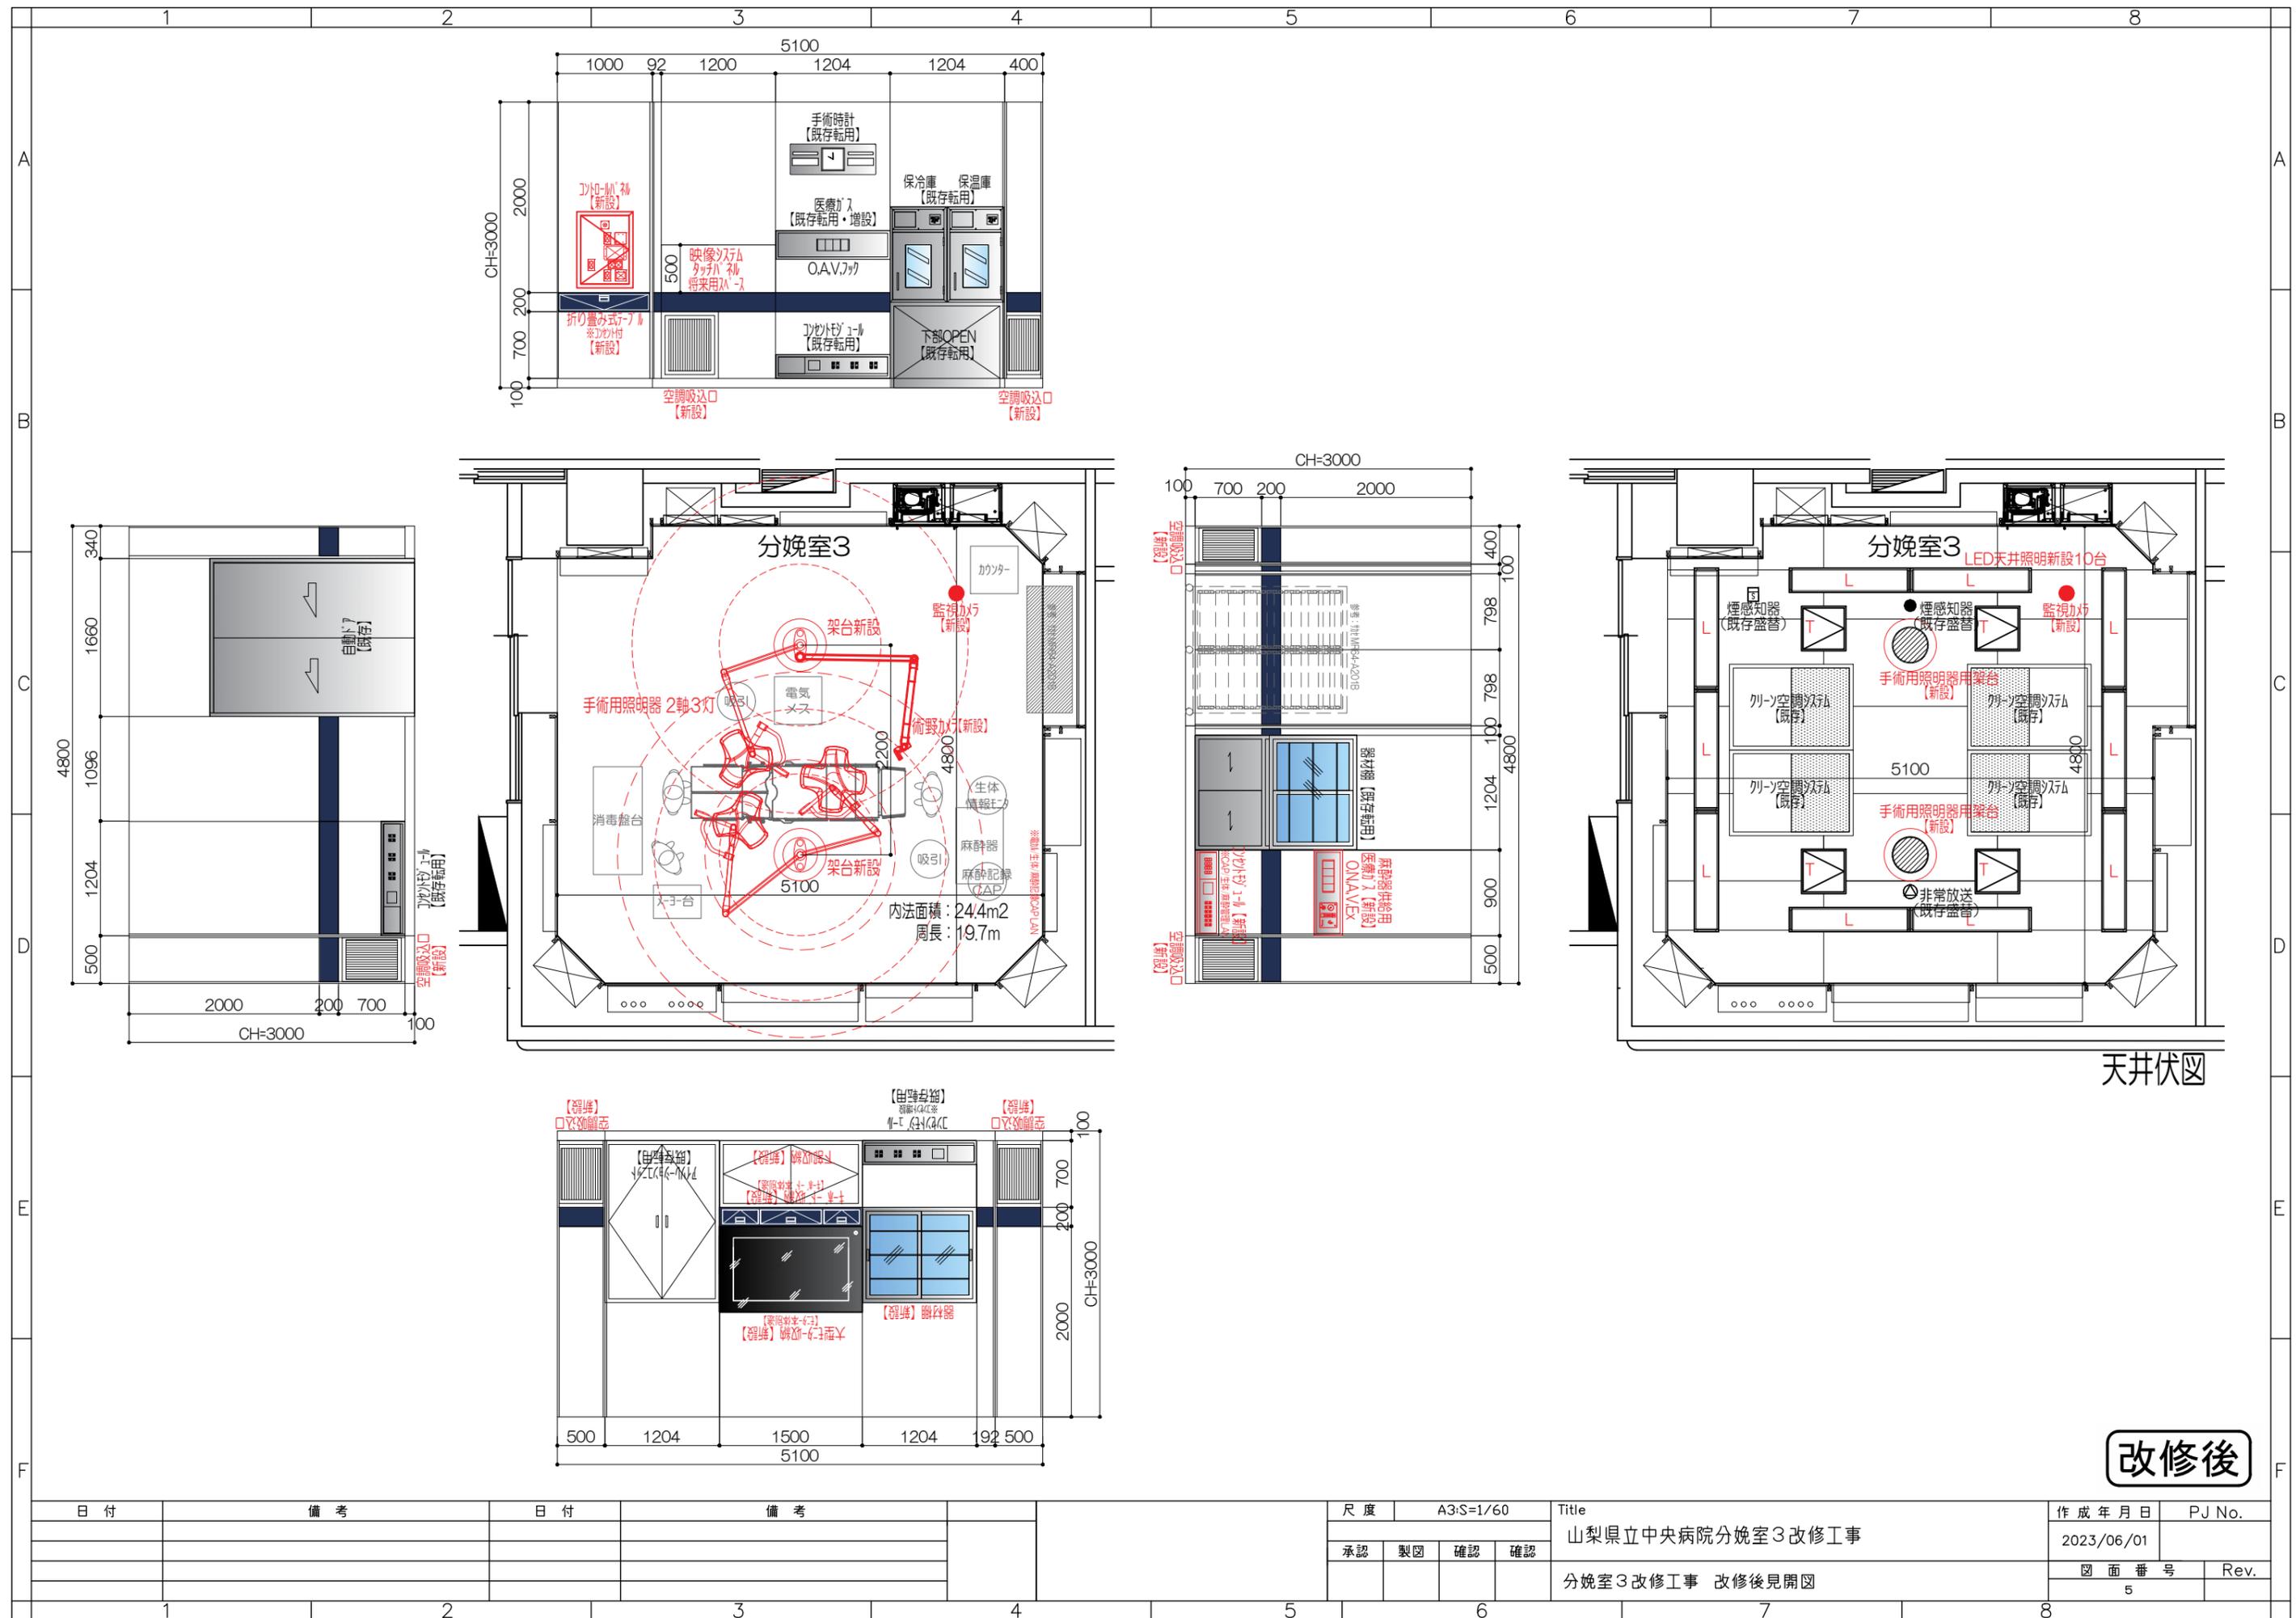

改修後




日付	備考	日付	備考

尺度	A3:S=1/60		
承認	製図	確認	確認

Title	山梨県立中央病院分娩室3改修工事
作成年月日	2023/06/01
図面番号	5
Rev.	

作成年月日	PJ No.
2023/06/01	
図面番号	Rev.
5	


分娩室3改修工事 改修後見開図

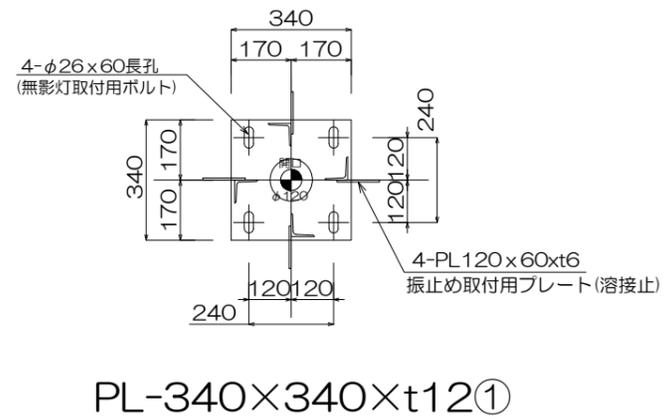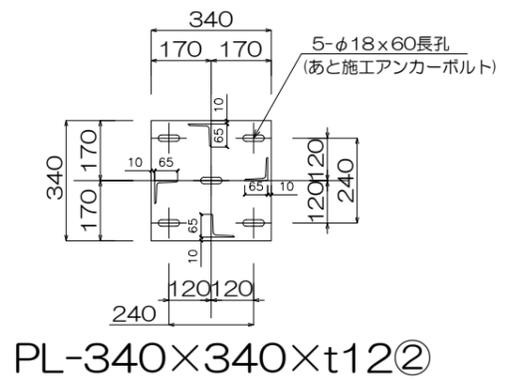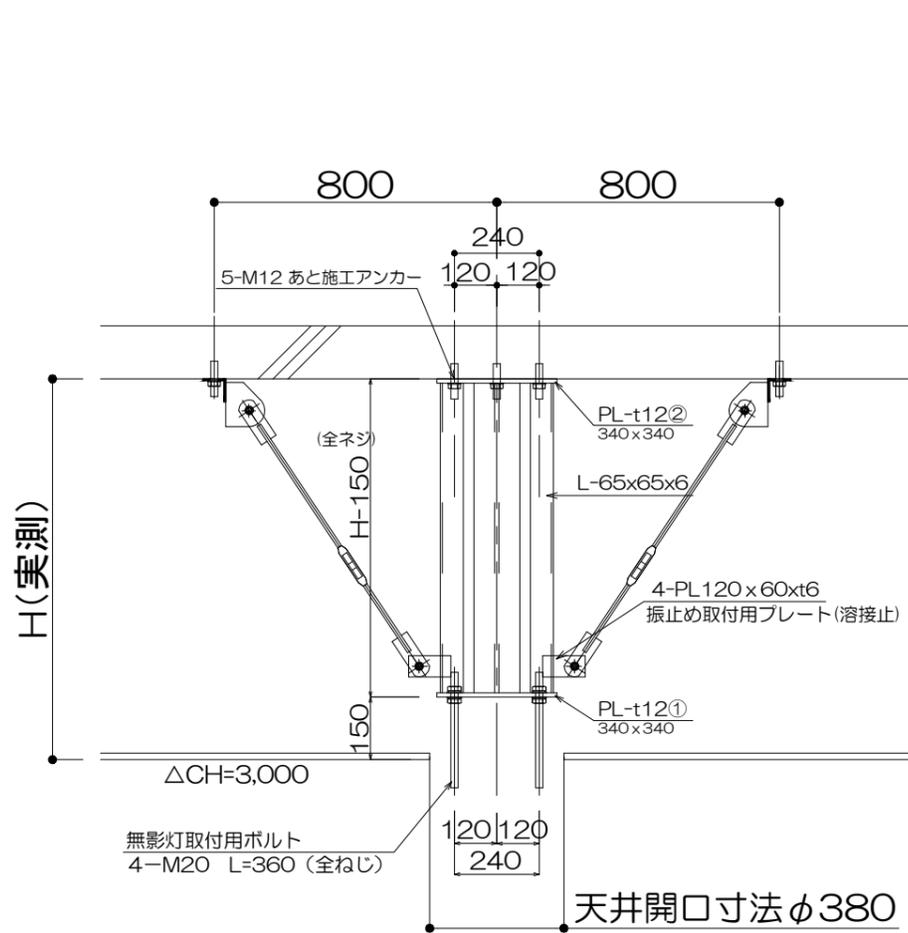

手術用照明器 天吊架台参考図

日付	備考	日付	備考

尺度	A3:S=1/20		Title	作成年月日	PJ No.
承認	製図	確認	確認	2023/06/01	
山梨県立中央病院分娩室3改修工事				図面番号	Rev.
分娩室3改修工事 手術用照明器架台参考図(あと施工アンカー)				8	

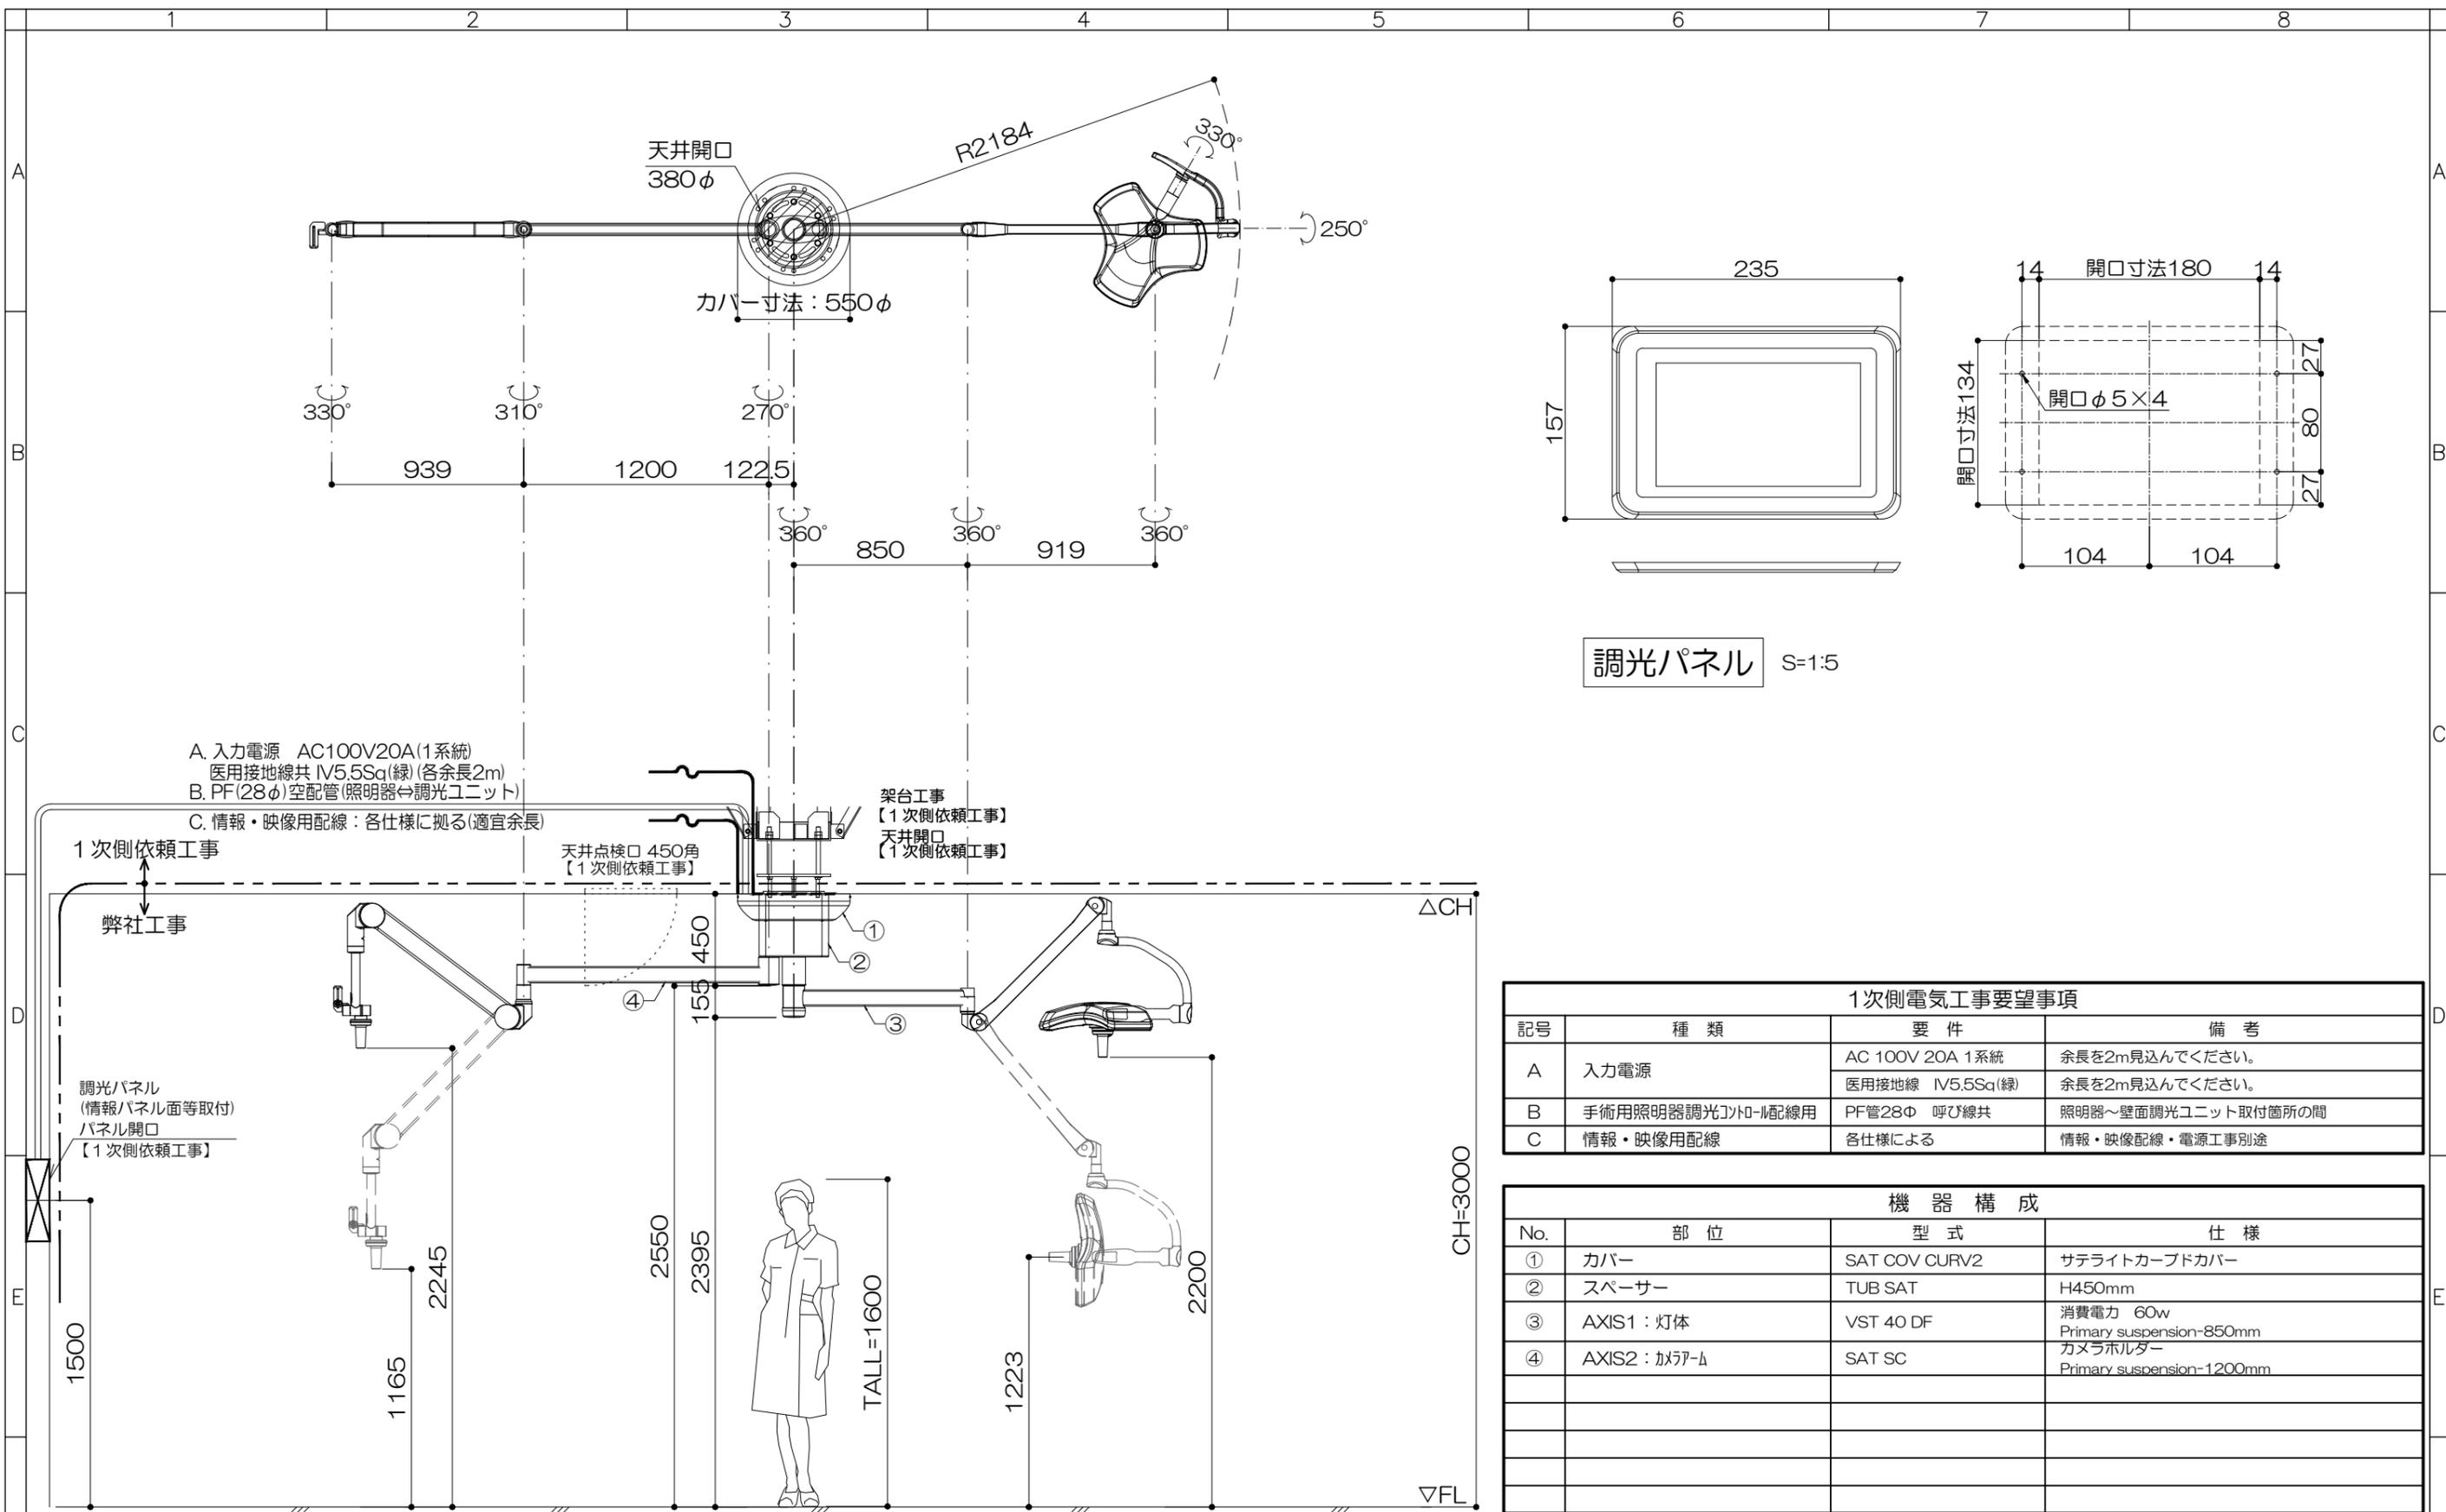

1次側電気工事要望事項			
記号	種類	要件	備考
A	入力電源	AC 100V 20A 1系統 医用接地線 IV5.5Sq(緑)	余長を2m見込んでください。
B	手術用照明器調光コントロール配線用	PF管28φ 呼び線共	照明器〜壁面調光ユニット取付箇所の間
C	情報・映像用配線	各仕様による	情報・映像配線・電源工事別途

機器構成			
No.	部位	型式	仕様
①	カバー	SAT COV CURV2	サテライトカーブドカバー
②	スパーサー	TUB SAT	H450mm
③	AXIS1: 灯体	VST 40 DF	消費電力 60w Primary suspension-850mm
④	AXIS2: カメラアーム	SAT SC	カメラホルダー Primary suspension-1200mm

VST40DF+SATSC
手術用照明器 副灯+カメラアーム **M2**

日付	備考	日付	備考	尺度	A3:1/30	Title	作成年月日	PJ No.
				承認	製図	確認	2023/06/01	
							図面番号	Rev.
						手術用照明器 VST40DF 参考図	10	